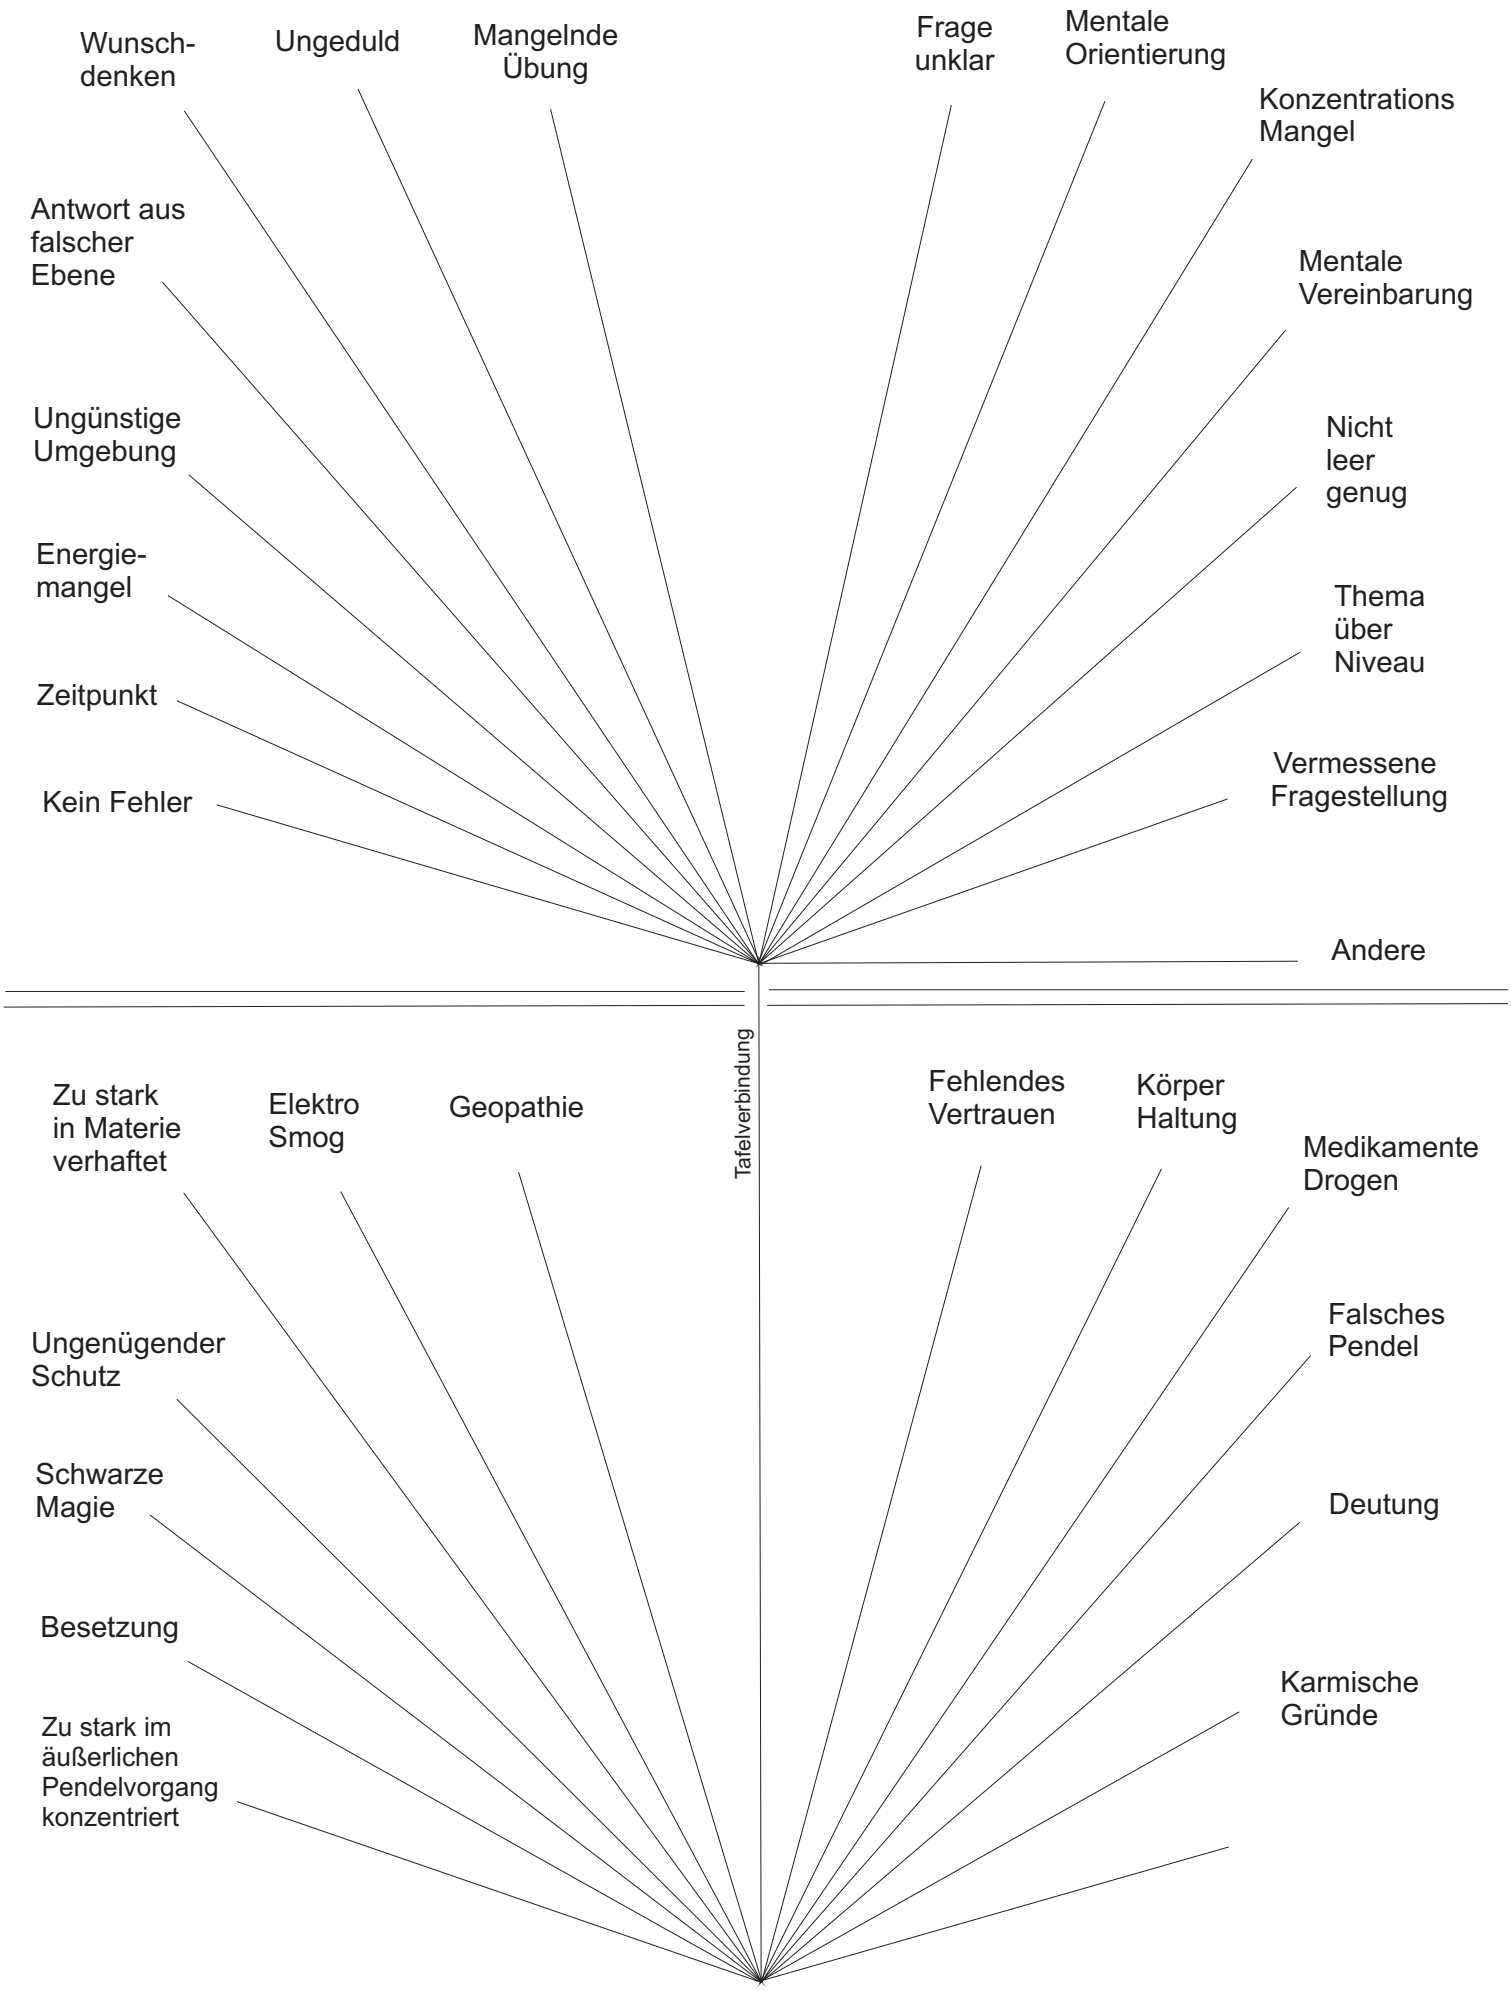

Fehlerursache

© Koch Radiästhesie